



Bei dieser Darstellung wird davon ausgegangen, dass die Laborgeräte mit dem IT-System über Schnittstellen verbunden sind.

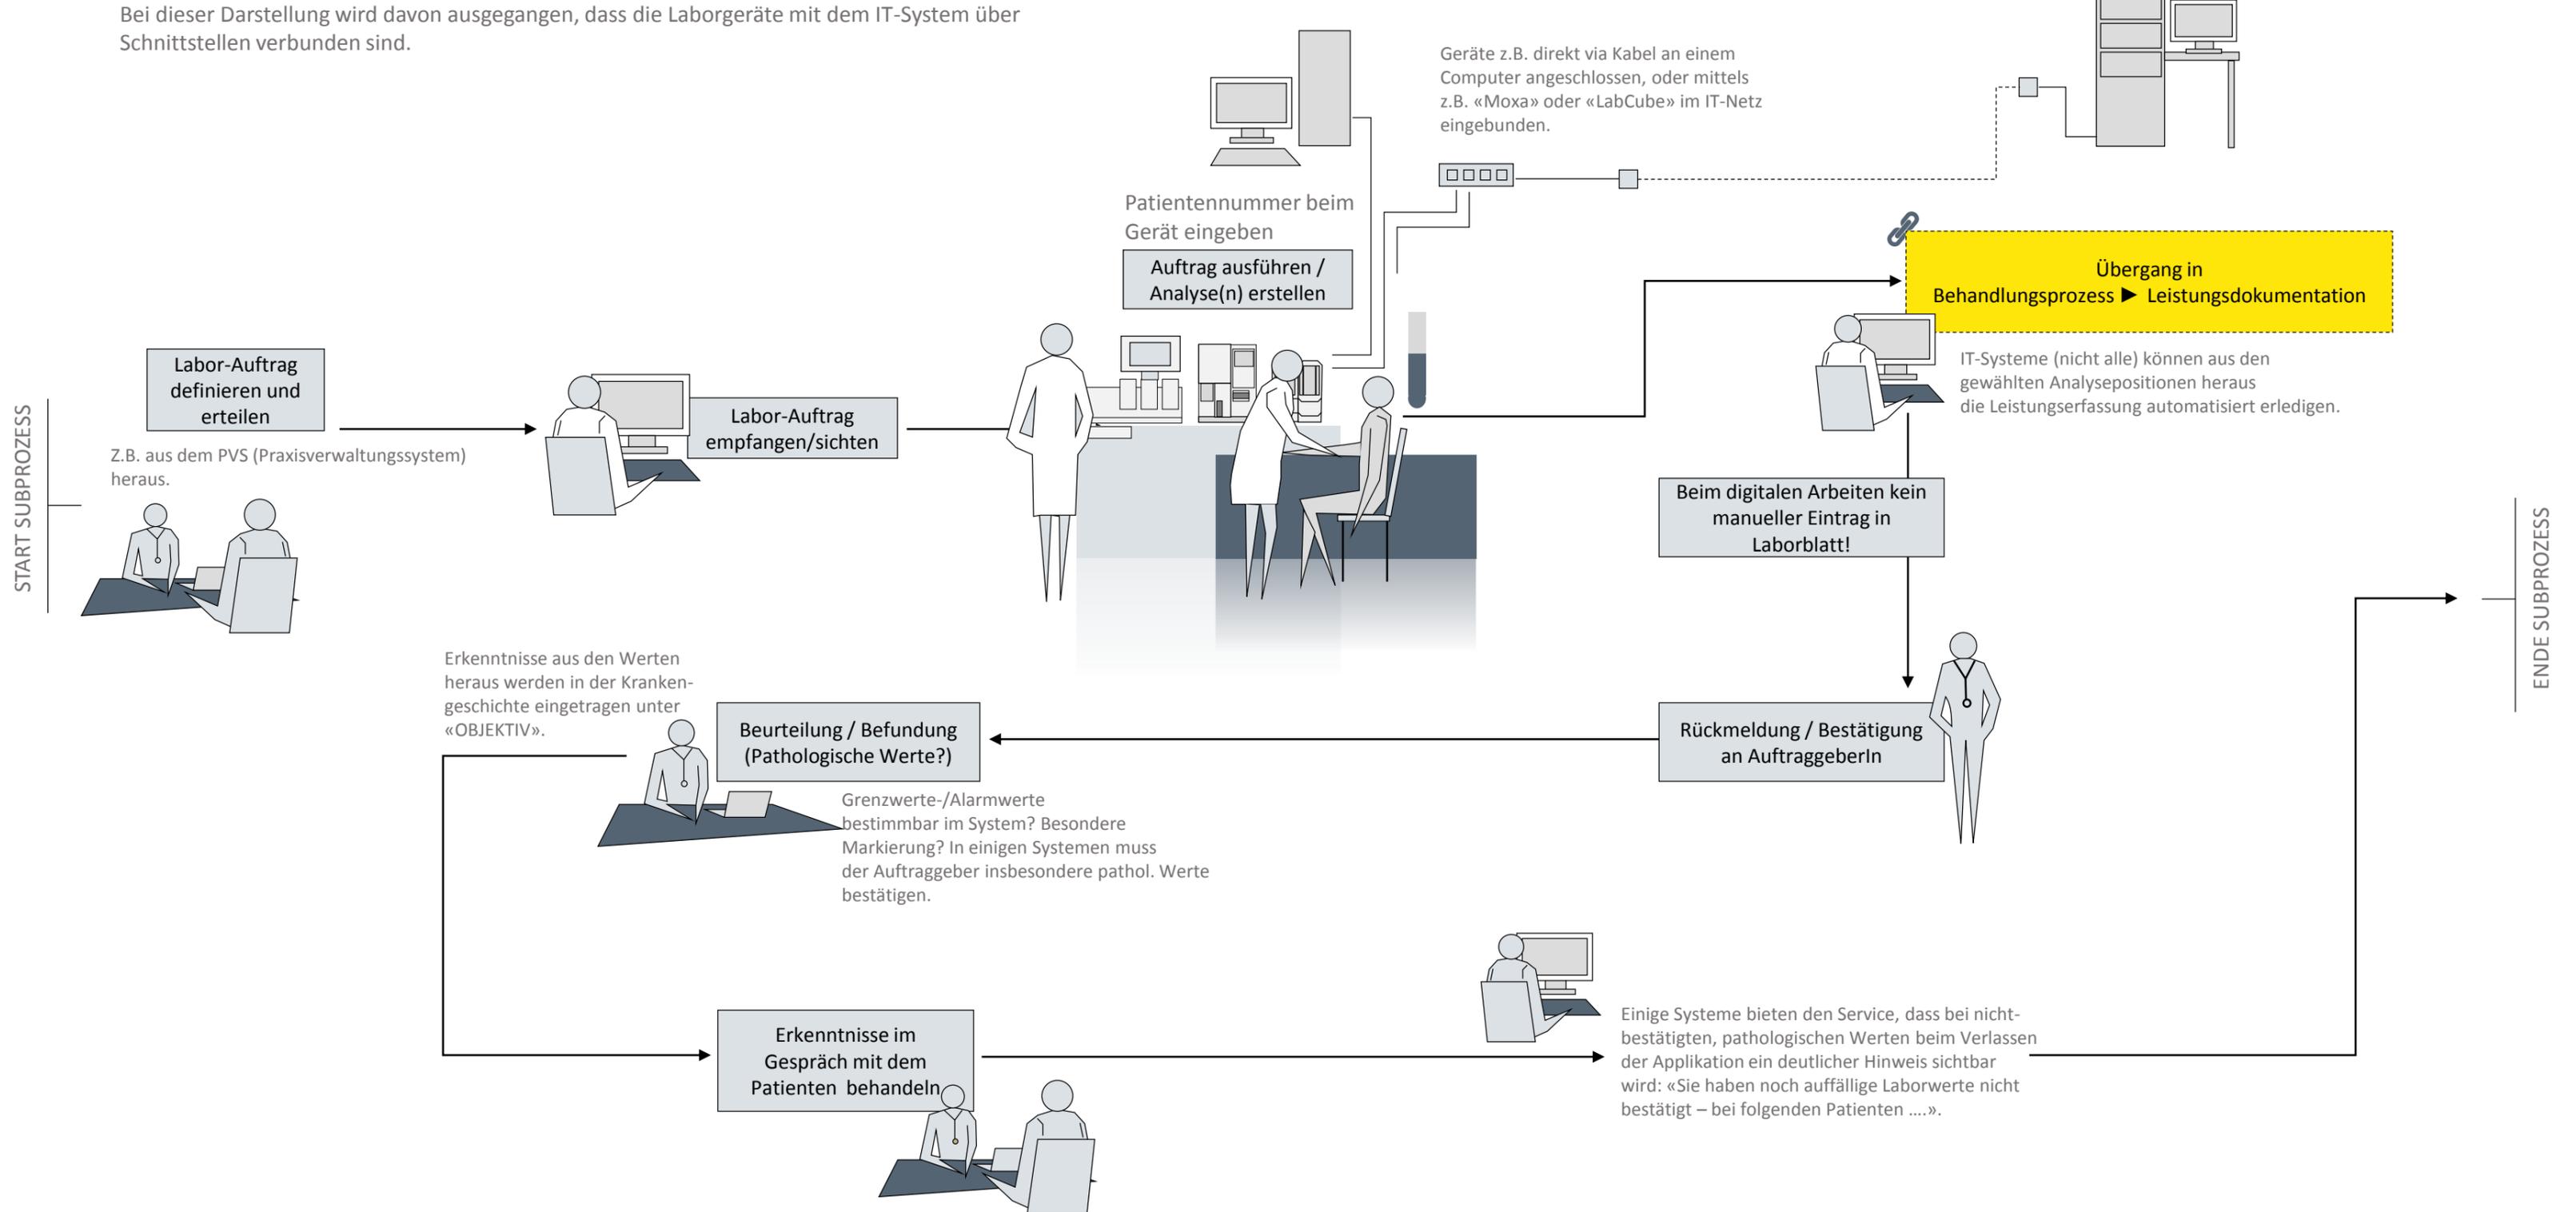

Werte werden in der Datenbank im System abgelegt – und im Laborblatt dargestellt.



Übergang in Behandlungsprozess ▶ Leistungsdokumentation

IT-Systeme (nicht alle) können aus den gewählten Analysepositionen heraus die Leistungserfassung automatisiert erledigen.

Beim digitalen Arbeiten kein manueller Eintrag in Laborblatt!

Rückmeldung / Bestätigung an AuftraggeberIn

Beurteilung / Befundung (Pathologische Werte?)

Grenzwerte-/Alarmwerte bestimmbar im System? Besondere Markierung? In einigen Systemen muss der Auftraggeber insbesondere pathol. Werte bestätigen.

Erkenntnisse im Gespräch mit dem Patienten behandeln

Einige Systeme bieten den Service, dass bei nicht-bestätigten, pathologischen Werten beim Verlassen der Applikation ein deutlicher Hinweis sichtbar wird: «Sie haben noch auffällige Laborwerte nicht bestätigt – bei folgenden Patienten».